



Life Science

Les normes européennes fournissent aux pays européens des directives de BPF. Les BPF requièrent la garantie de la qualité de ces produits, incluant le contrôle de la contamination des produits au cours de la fabrication et de l'emballage. En général, le contrôle de la contamination est crucial surtout lorsqu'il s'agit de préparations injectables ou parentérales par rapport aux préparations à administration locale ou orale. Les gouttes ophtalmiques peuvent être considérées comme une préparation à appliquer localement, mais constitue une exception à cette règle car l'œil est particulièrement propice aux infections.

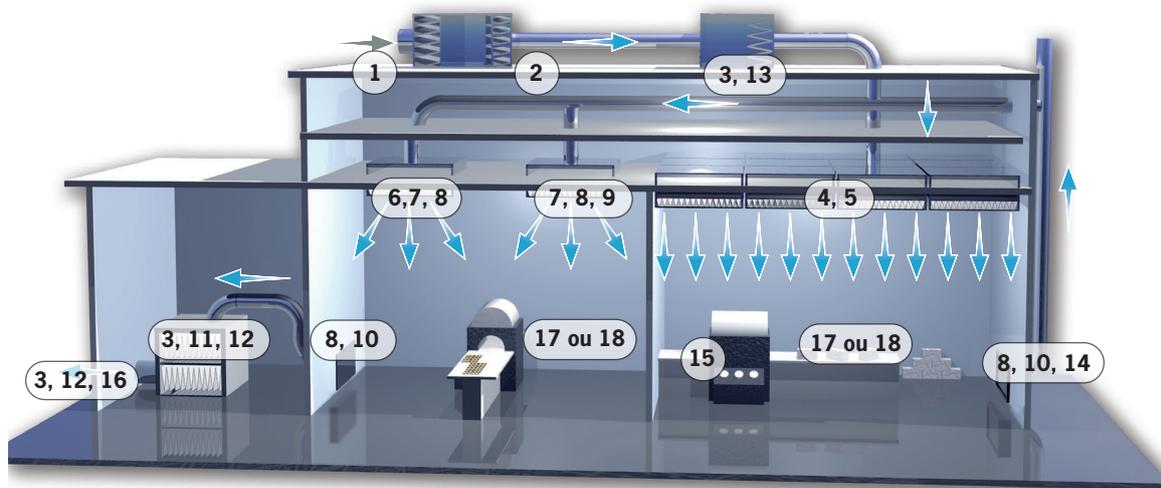

Ces recommandations sont basées sur des critères existants tels que publiés par les autorités compétentes, sur les meilleures pratiques s'appuyant sur des données publiées. Pour votre demande spécifique, contactez Camfil qui vous proposera une solution précise répondant à vos besoins.



1. Hi-Flo ProSafe



2. Opakfil ProSafe



3. Absolute V ProSafe




4. CamGrid



5. Megalam Gel



6. Pharmaseal



7. Diffuseurs d'air



8. Megalam MX, MG



9. CleanSeal



10. CleanSeal Exhaust



11. CamSafe 2



12. Airopac



13. CamCube AS



14. EcoPleat



15. Absolute D-Pyro



16. CamSafe WM



17. Gold Series Camtain



18. Quad Pulse Package (QPP)

